Pro Check Hızlı Protein Kalıntı Testi

Kesinlikle daha iyi bir protein kalıntı testi

Geniş Kapsamlı Endoskop ve Alet Kontrol Testi 10 Saniyede Sonuç

DAKE MEDİKAL
Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

- ✓ ISO 15883'e uygundur
- ✓ 10 saniye için sonuç alınır
- ✓ Kullanılması kolay – inkübasyon gerektirmez
- ✓ Net renk değişimi
- ✓ Düşük maliyetli
- ✓ Aşağıdakilerle kullanım içindir:
- ✓ Endoskoplar
- ✓ WD/ Ultrasonik yüzeyler
- ✓ Cerrahi aletler

Pro Check 1 Kutu Koruyucu Straforlu Çekmeçeli Kutu
24 Adet vida-Contalı kapak küçük şişe
24 Adet kısa çubuklu swap
24 Adet tüp üzerinde etiket
1 Adet kontrol

Pro Check Hızlı Protein Kalıntı Testi

Pro Check protein testi yıkayıcılar-dezenfekte cihazları, ultrasonik temizleyiciler, endoskoplar ve diğer temizlenmesi zor cerrahi aletlerin yüzeyleri üzerinde geri bırakılan kalıntı proteinleri tespit etme kabiliyeti olan hızlı bir protein testtir. Bu protein testi klinik kimya içinde kullanılan bir boya-bağlama solüsyonu esaslıdır ve **1 µg hassasiyet** içinde protein kalıntılarını tespit edebilir.

Pro Check Endoskoplar ve Lümenli Parçalar İçin;

Endoskoplarınızın temizle işlemi bittikten sonra iç lümenleri kurumadan önce; Skop yuvasından boş olan uç kısımları ilerletin skopun uç kısmından çıkan plastik hattı hızlıca çekin. Eğer kalıntı varsa conta uç swap kalıntıları süpürerek çekecektir. Gelen uç kısımları hemen tüpe daldırın veya uçları tüpün içine keserek bırakın. Eğer kalıntı varsa 10 - 15 saniyede tüp içindeki kahverengi renk boya bağlama solusyonu sıva mor veya daha koyu mor renkine dönecektir.

Pro Check 1 Kutu
50 Adet Contalı vida kapaklı tüp
50 Adet Etiket (Tüp üzerinde)
4 Adet Distile su
50 Adet 2.2M uzunluğunda Spiralli Contalı plastik çubuk Kalınlık 1 mm, ucu 2.8mm-5mm swap

DAKE | Arjantin Caddesi No: 23/8 | P.K:06700 | GOP | Ankara | Türkiye | TR |
T: 0 312 4276240 | F: 0 312 4276241 | www.dake.com.tr | dake@dake.com.tr

Adı:	3C Pro Check
Uygunluk:	BS EN ISO 15883, HTM 2030
Süre:	10 saniye içinde sonuç alınır
Depolama şartları:	2°C ile 25°C Arasında
Lot no:	Evet, kutu üzerinde
Son kullanım tarihi:	Evet, kutu üzerinde
Doğru semboller:	Evet, standarda uygun olarak
İndikatör:	Vida kapaklı tüpler Diyagnostik boya-bağlama solüsyonu içerir
Son kullanım tarihi:	Oda sıcaklığında 18 ay
Ambalajlama:	Koruyucu Straforlu çekmeceli ktu içerisinde contalı vida kapaklı tüpler Pamuklu çubuk veya endoskoplar için spiralli pamuklu swap, (Pozitif kontrol için bir protein içeriği olan materyel)

Uygulama talimatı

Pro Check kutu içerisinden bir adet **Pro Check** tüp cıkarın. Yıkama makinasından çıkmış yıkanmış cerrahi aletlerin yüzeyinden proteinin mevcut olup olmadığını tespit etmek için, yüzeyi ıslak pamuklu çubuk-swap ile silin, pamuklu çubuğu renk değiştirme solüsyonu içine yerleştirin ve pamuklu çubuğu 5-10 saniye döndürün. Pamuklu çubuk daha sonra atılabilir veya içine bırakınız. Eğer protein mevcut ise, **Pro Check 10-15 saniye içinde mor renge dönecektir.** protein kalıntı seviyesi ne kadar yüksek olursa (canlı organizma protein kaynağı) protein varlığı için mor renk değişikliği o kadar koyu tonlara hızlı bir şekilde gelişecektir. **Pro Check** kalıntı tespiti ile renk değişimi yüzey temizliğinin yarı-kantitatif bir ölçümünü sağlar.

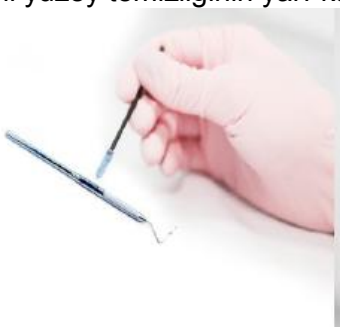

HIZLI PROTEİN KALINTI TEST SONUCU REFERANS TABLOSU

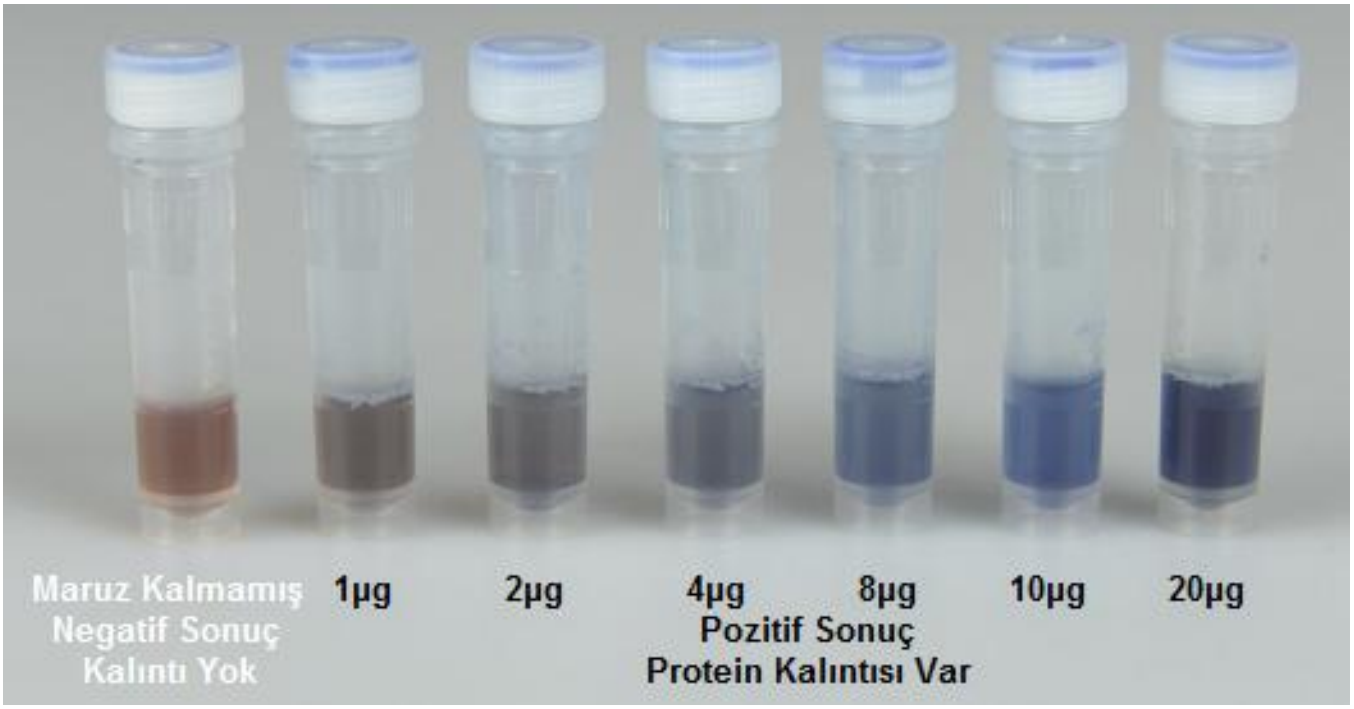

DAKE | Arjantin Caddesi No: 23/8 | P.K:06700 | GOP | Ankara | Türkiye | TR |
T: 0 312 4276240 | F: 0 312 4276241 | www.dake.com.tr | dake@dake.com.tr